

お客様各位

ラベル記載内容変更のご案内

謹啓

時下 益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。さて、このたび下記製品群の製造販売元である株式会社アムコより『Remel(リーメル)社製品 ラベル変更のお知らせ』がございましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社製品につきまして、引き続きのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 対象製品

統一商品 コード No.	製品名	包装・内容	メーカー 品番
551-63802-8	RapID™ STR System 連鎖球菌同定用キット	20テスト分	I130210
551-63803-5	RapID™ ANA II System 嫌気性細菌同定用キット	20テスト分	I130265
551-63800-4	RapID™ ONE System 腸内細菌及び酸化酵素不活性グラム陰性桿菌同定用キット	20テスト分	I130348
551-63801-1	RapID™ NF Plus System ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌同定用キット	20テスト分	I130333
551-63804-2	RapID™ CB Plus System コリネバクテリア及び同属細菌同定用キット	20テスト分	I130360
551-63805-9	RapID™ NH System ナイセリア・ヘモフィルス菌同定用キット	20テスト分	I130256
551-63806-6	RapID™ Yeast Plus System 酵母菌及び酵母様真菌同定用キット	20テスト分	I130350

2. 変更内容

同定キットの英語ラベルに記載された製造国が、アメリカからイギリスへと変更されます。
 ※付属試薬の英語ラベルおよび日本語表記された外箱ラベルの変更はございません。
 ※詳細は、株式会社アムコからの『Remel(リーメル)社製品 ラベル変更のお知らせ』をご参照ください。

3. 変更理由

製造工場が移転するため

4. 変更時期

2020年8月以降製造分より変更予定

※新型コロナウイルス感染症の影響により変更する可能性があります。

以上

2020年4月

極東製薬工業株式会社 御中

東京都千代田区飯田橋4-8-7

株式会社アムコ

Remel（リーメル）社製品 ラベル変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。また平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有り難く御礼申し上げます。

さて、毎々ご購入いただいておりますリーメル社製、迅速細菌同定キット「RapID™ シリーズ」に関しまして、この度製造元によるラベル記載内容の変更通知がございましたので、ここにお知らせ申し上げます。変更の詳細については下記をご確認下さい。

なお、この度の変更に伴う製品仕様の変更はございませんので、お客様にはこれまで同様に製品をご使用いただけます。

敬具


記

<対象製品>

ご注文番号	製品名
I130210	RapID™ STR System 連鎖球菌同定用キット
I130265	RapID™ ANA II System 嫌気性菌同定用キット II
I130348	RapID™ ONE System 腸内細菌及び酸化酵素不活性グラム陰性桿菌同定用キット
I130333	RapID™ NF Plus System ブドウ糖非発酵グラム陰性桿菌同定用キット
I130360	RapID™ CB Plus System コリネバクテリア及び同属細菌同定用キット
I130256	RapID™ NH System ナイセリア・ヘモフィルス菌同定用キット
I130350	RapID™ YEAST Plus System 酵母菌及び酵母様真菌同定用キット

<変更理由> 製造工場をアメリカ合衆国からイギリスに移転するため。

<変更箇所> 最下部の製造国表記が「Made in UK」に変更されます。

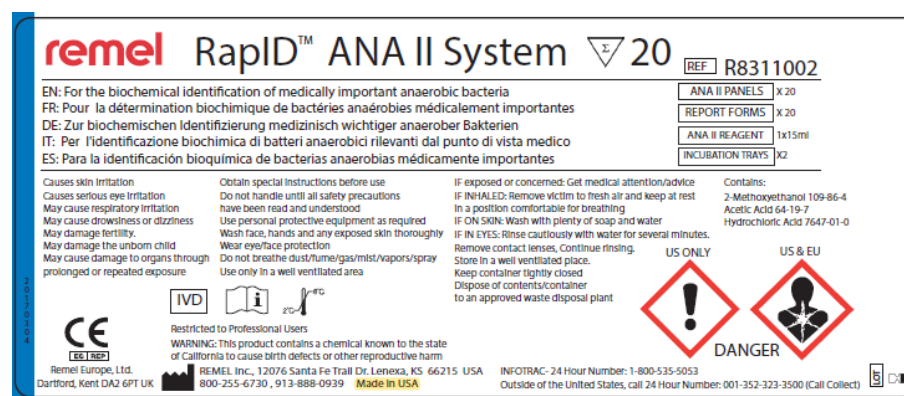

<変更開始時期> 2020年8月以降の出荷製品に反映される見込みです。

以上