鼻咽頭検体又は咽頭ぬぐい液中の
RSウイルス抗原及び/又はアデノウイルス抗原の検出

SEKISUI

体外診断用医薬品
承認番号30400EZX00022000

RS ウイルスキット / アデノウイルスキット

ラピッドテスタ RSV−アデノsp

特長

1. 検体抽出後、～5[※1]分で判定できます。
2. 1回の検査でRSウイルスと
アデノウイルスの検出が同時にできます。
3. 検体希釈液はラピッドテスタ FLUスティックsp、
ラピッドテスタ hMPV[※2]にも使用できます。

測定原理

イムノクロマト法

※1 テストラインとコントロールラインが認められた場合、その時点で陽性と判定することができます。
※2 ラピッドテスタ hMPV は極東製薬工業株式会社では取り扱いがございません。

内容

名称		包装
ラピッドテスタ RSV-アデノsp （10回用） 貯蔵方法：2～30℃ 有効期間：製造後2年間	ラピッドテスタ検体希釈液	0.5mL×10本
	テストスティック	10本
	《付属品》滅菌綿棒（鼻腔検体採取用）	10本

「ラピッドテスタ」は積水メディカル株式会社の日本における登録商標です。

極東製薬工業株式会社

検体採取法

》鼻咽頭検体

《鼻腔ぬぐい液》



鼻腔検体採取用綿棒（キット付属品）を鼻腔から耳孔を結ぶ平面を想定し挿入します。コトンと行き止まる鼻腔の奥まで綿棒が達したら、鼻腔粘膜を数回こすり取ります。

《鼻腔吸引液》



吸引装置にトラップ付き吸引カテーテルをセットし、一方のカテーテルの先を鼻腔に入れ、鼻腔液を吸引し、吸引トラップに検体を採取します。

》咽頭ぬぐい液



大きく口をあけ、舌圧子で舌を押さえます。口蓋扁桃、咽頭後壁に別売の咽頭ぬぐい液採取用綿棒を強くこすりつけ、検体をていねいに採取します。このとき綿棒が頬の内側、舌や歯に触れないように注意します。

すぐに次の操作に移れない場合　試料を冷蔵(2～10℃)で24時間、凍結(-20℃以下)で2週間保存する事ができます。冷蔵、凍結保存した検体は室内温度(15～30℃)に戻してから使用してください。

測定法

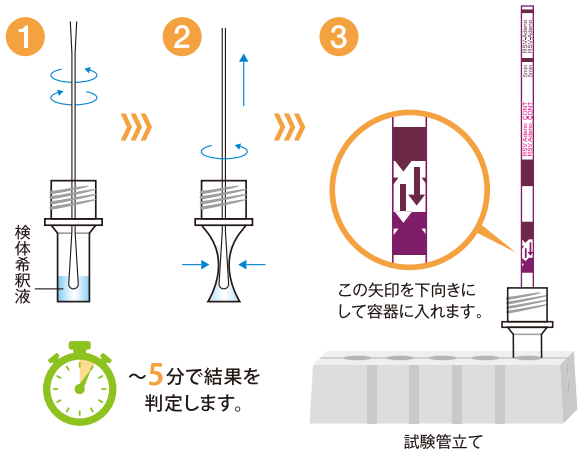

1. 綿棒を検体希釈液に入れ、回すようにして検体を抽出します。
2. 綿球をチューブの上から指で挟み、綿球内の検体をよく搾り出します。
3. チューブにテストスティックを浸漬させ、反応させます。

判　定

陽性ライン（RS、アデノ又はその両方）とコントロールラインが認められた時点で判定可能です。陽性ラインが認められない場合は必ず5分まで静置してから判定してください。

RSウイルス陽性



アデノウイルス陽性

RSウイルス、アデノウイルス陽性

陰性

無効　判定域のコントロール部位にラインが認められない。

無効　判定域全体が着色して、テストラインやコントロールラインが認められない。

注）5分以内に一方の陽性ラインが認められた場合でも、もう一方の感染を否定するものではありません。

相　関

「ラピッドテスタ　RSV-アデノsp」電子添文より

RSウイルス（鼻咽頭検体）

		PCR法		合計
		＋	－	
本品	＋	182	0	182
	－	4	260	264
合計		186	260	446

感　度	97.8%（182／186）
特異性	100%（260／260）
一致率	99.1%（442／446）

アデノウイルス（鼻咽頭検体）

		PCR法		合計
		＋	－	
本品	＋	62	0	62
	－	6	378	384
合計		68	378	446

感　度	91.2%（ 62／ 68）
特異性	100%（378／378）
一致率	98.7%（440／446）

＊キットご使用の際には電子化された添付文書をよくお読みください。
＊測定結果に基づく臨床判断は、臨床症状や他の検査結果などと合わせて担当医師が総合的に判断してください。

販売元
極東製薬工業株式会社
本社　〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町7-8　TEL 03-5645-5664
URL　https://www.kyokutoseiyaku.co.jp/
札幌営業所　TEL 011-532-2551(代)　名古屋営業所　TEL 052-789-0666(代)
仙台営業所　TEL 022-238-8721(代)　大阪営業所　TEL 06-6304-5446(代)
東京営業所　TEL 03-5645-5701(代)　中四国営業所　TEL 082-262-5446(代)
首都圏センター営業所　TEL 03-5645-5851(代)　福岡営業所　TEL 092-287-9385(代)

製造販売元
積水メディカル株式会社
〒103-0027 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
TEL 03-3272-0671（代表）

2022.8-01